



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ»
(ФБУ «РОСТЕСТ - МОСКВА»)

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

№ СК 0080785

Средство измерений

Профилометр Dektak 150

наименование и тип (если в состав средства измерений

входят несколько автономных блоков, то приводят их перечень)

заводской номер (номера)

25111

изготовитель

Veeco Instruments Inc., США

принадлежащее

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

наименование юридического (физического) лица, ИНН

ИНН 7722019652

Условия калибровки

20±3°C

Калибровка проведена по методике

МП ВНИИМС

наименование или номер нормативного документа

В качестве эталона применен

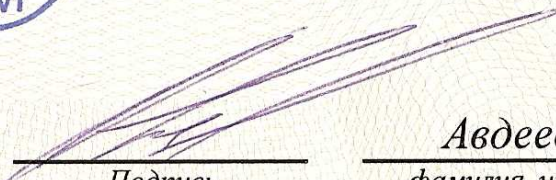
3.1.ZMA.0276.2015, 3.1.ZMA.0283.2015

наименование, заводской номер, разряд, класс или погрешность

Калибровочное клеймо



Начальник
лаборатории №445


Подпись

Авдеев А.Б.
фамилия, инициалы

«16» февраля 2016 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ КАЛИБРОВКИ

Действительное значение меры, мкм	Результат измерений, мкм
Ra 0.0318	Ra 0.0309
Ra 0.2653	Ra 0.2583
Ra 0.6630	Ra 0.6299
Ra 2.0461	Ra 1.7948
Rmax 5.620	Rmax 5.807

Стандартное отклонение параметра Ra 0,9%

Отклонение от прямолинейности перемещения 1,5 мкм.

Измерения проводились щупом с радиусом закругления 12,5 мкм.

Поверитель

«16» февраля 2016 г.


Подпись

Косинский Д.В.

фамилия, инициалы

117418 Москва, Нахимовский пр., 31
Call-Центр: 495-544-00-00
тел. 499-129-19-11 факс: 499-124-99-96
Email: info@rostest.ru, www.rostest.ru